Contrôle conformité

numéro de suivi : dossier n°55

PROFESSIONNEL

Établissement de démonstration

12 rue de l'Exemple 99999 Démoville

04 65 71 00 00

contact@etablissement-demo.example

SIRET : fictif

BÉNÉFICIAIRE


DEM-B0001

correspondance tenue dans le dossier de l'usager

Prescripteur : Dr Alix Démo (médecin de rééducation)

Dispositif

Fourche Joystick fauteuil
Description : Fourche qui se fixe sur la manette du fauteuil roulant électrique et guide la main pour piloter sans saisir la boule d'origine.
Fonctionnalités : Piloter avec la paume, sans pince des doigts ; tenir sur la manette sans jeu ; se retirer sans outil pour le nettoyage.
Dispositif associé : Fauteuil roulant électrique de la personne
Numéro de série du dispositif associé : /

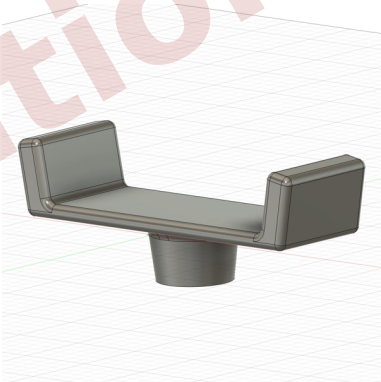

Démonstration

Rappel des actions préventives de l'analyse de risques

IL PEUT CASSER	PETG, remplissage 30 %, parois 1,2 mm, branches dans le sens des couches / Vérifier chaque semaine l'absence de fissure sur les branches.
IL PEUT SE DESSERRER OU GLISSER	Fixation ajustée à la cote mesurée sur la manette / Si la fourche tourne ou bouge, cesser de l'utiliser et prévenir l'ergothérapeute.
UN BORD OU UNE ARÊTE PEUT BLESSER	Arêtes arrondies à la conception, ébavurage après impression

Informations fabrication

Machine utilisée : A1 mini de démonstration

DATE DE FABRICATION	04/09/2026	HAUTEUR DE COUCHE	0,2 mm
NOM DU SITE DE FABRICATION	Établissement de démonstration	ÉPAISSEUR PAROIS	1,2 mm
VÉRIFICATEUR	Camille Démo, ergothérapeute	TAUX DE REMPLISSAGE	30 %

Post-traitement

- Retrait des supports
- Ébavurage

Vérifications qualité

- Les dimensions mesurées conviennent
- Pas d'arêtes vives ni bavures
- Couches bien soudées (pas de délaminage)
- Ajustement essayé sur le dispositif ou auprès du patient

Vérification matériaux

MATÉRIAU PRÉVU (CDC)	PETG	COULEUR PRÉVUE (CDC)	Noir
MATÉRIAU CONSTATÉ (BOBINE)	PETG	COULEUR CONSTATÉE (BOBINE)	Noir
BOBINE UTILISÉE	DEM-PETG-001 (PETG Noir)	COMPATIBLE CONTACT ALIMENTAIRE	Non

Cotes attendues et mesurées

DIAMÈTRE DE FIXATION SUR LA MANETTE	Attendu : 18 mm	Mesuré : 18,1 mm
ÉCARTEMENT DES BRANCHES	Attendu : 32 mm	Mesuré : 31,8 mm
COMMENTAIRE	Cotes mesurées au pied à coulisse, conformes au cahier des charges.	

Contrôle conformité réalisé par Camille Démo, ergothérapeute suite à la fabrication du 05/09/2026.

Démonstration